



## 2) 血液透析濾過

### (5) HDF患者の置換液量の年次推移 (図表36)

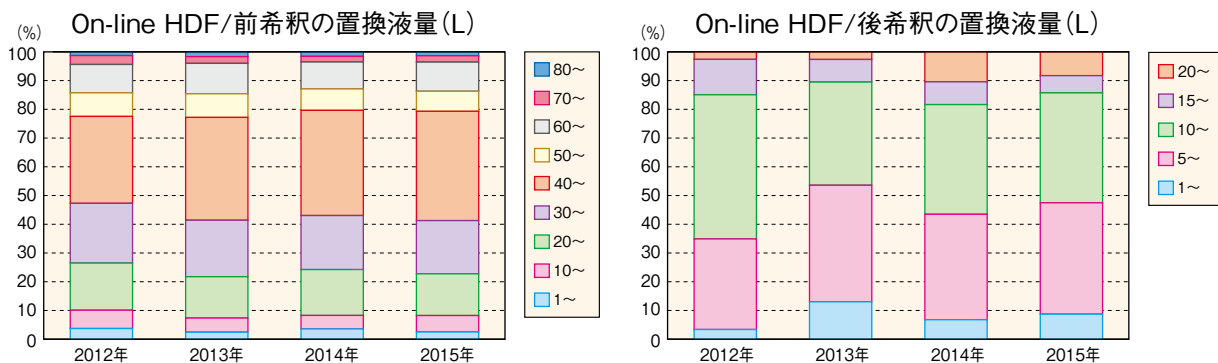

	1L~	10L~	20L~	30L~	40L~	50L~	60L~	70L~	80L~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2012年 (%)	415 (3.7)	711 (6.4)	1,829 (16.4)	2,320 (20.8)	3,373 (30.2)	913 (8.2)	1,102 (9.9)	345 (3.1)	145 (1.3)	11,153 (100.0)	122	11,275	39.1	16.7
2013年 (%)	464 (2.4)	936 (4.9)	2,728 (14.4)	3,730 (19.7)	6,791 (35.8)	1,558 (8.2)	2,009 (10.6)	445 (2.3)	316 (1.7)	18,977 (100.0)	267	19,244	40.6	15.8
2014年 (%)	1,030 (3.6)	1,347 (4.7)	4,583 (16.0)	5,399 (18.8)	10,512 (36.6)	2,138 (7.4)	2,693 (9.4)	563 (2.0)	450 (1.6)	28,715 (100.0)	1,166	29,881	39.6	15.8
2015年 (%)	907 (2.5)	2,068 (5.7)	5,233 (14.5)	6,687 (18.5)	13,727 (38.0)	2,514 (7.0)	3,660 (10.1)	794 (2.2)	494 (1.4)	36,084 (100.0)	694	36,778	40.1	15.5

	1L~	5L~	10L~	15L~	20L~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2012年 (%)	31 (3.4)	289 (31.5)	460 (50.2)	113 (12.3)	24 (2.6)	917 (100.0)	36	953	10.6	3.9
2013年 (%)	172 (13.0)	536 (40.6)	474 (35.9)	104 (7.9)	35 (2.6)	1,321 (100.0)	118	1,439	9.2	4.5
2014年 (%)	89 (6.8)	482 (36.7)	501 (38.2)	104 (7.9)	137 (10.4)	1,313 (100.0)	29	1,342	10.6	5.0
2015年 (%)	141 (8.7)	627 (38.8)	619 (38.3)	97 (6.0)	134 (8.3)	1,618 (100.0)	39	1,657	10.0	4.8

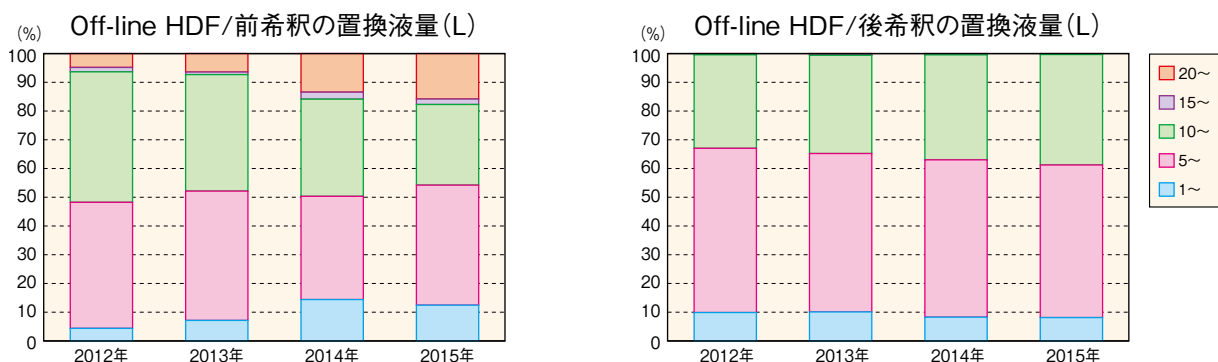

	1L~	5L~	10L~	15L~	20L~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2012年 (%)	20 (4.4)	200 (43.9)	207 (45.4)	7 (1.5)	22 (4.8)	456 (100.0)	29	485	9.2	3.8
2013年 (%)	40 (7.1)	252 (45.0)	227 (40.5)	5 (0.9)	36 (6.4)	560 (100.0)	20	580	9.4	4.7
2014年 (%)	89 (14.4)	222 (35.9)	209 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.4)	618 (100.0)	20	638	10.2	6.6
2015年 (%)	59 (12.4)	198 (41.8)	133 (28.1)	9 (1.9)	75 (15.8)	474 (100.0)	25	499	10.6	7.1

	1L~	5L~	10L~	15L~	20L~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2012年 (%)	492 (9.9)	2,845 (57.2)	1,620 (32.5)	16 (0.3)	5 (0.1)	4,978 (100.0)	71	5,049	7.8	2.3
2013年 (%)	508 (10.1)	2,775 (55.1)	1,722 (34.2)	16 (0.3)	13 (0.3)	5,034 (100.0)	180	5,214	7.9	2.4
2014年 (%)	338 (8.3)	2,235 (54.7)	1,492 (36.5)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,083 (100.0)	192	4,275	8.0	2.3
2015年 (%)	293 (8.1)	1,913 (53.1)	1,385 (38.4)	7 (0.2)	5 (0.1)	3,603 (100.0)	169	3,772	8.1	2.2

集計対象：血液透析濾過患者

#### 解説

On-line HDFおよびOff-line HDFの置換液量の年次推移を示す。On-line HDF/前希釈では、患者数は年々増加傾向であるが、置換液量の平均値や分布に変化はなかった。On-line HDF/後希釈もほぼ同様の結果であったが、20L以上の置換液量の割合が徐々に増加傾向を示した (2.6→2.6→10.4→8.3%)。

一方Off-line HDF/前希釈では、2015年に患者数が低下傾向を示したものの、置換液量に関して、その平均値は年々わずかながら増加傾向を示した。特に20L以上の層の割合は顕著に増加した (4.8→6.4→13.4→15.8%)。Off-line HDF/後希釈では、患者数の減少を認め、置換液量の平均値のわずかな増加傾向を認めた。