


1) 透析液水質管理状況

(4) エンドトキシン捕捉フィルタ (ETRF) 装着状況 (図表25)

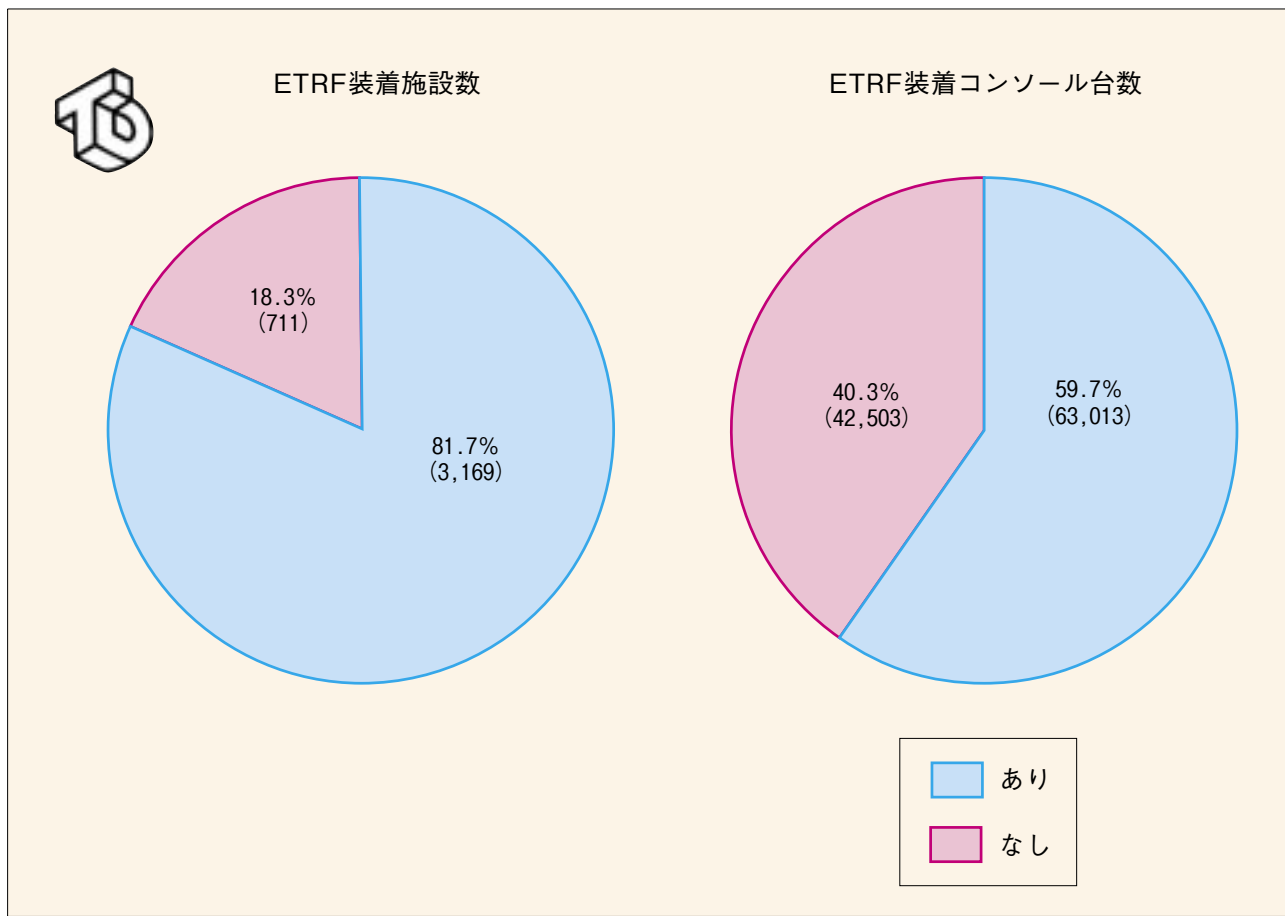

ETRF装着	あり	なし	合計	記載なし	総計
施設数	3,169	711	3,880	170	4,050
頻度 (%)	81.7	18.3	100.0		

ETRF装着	あり	なし	合計
コンソール台数	63,013	42,503	105,516
頻度 (%)	59.7	40.3	100.0

施設調査による集計

解説

ETRFの装着について4,050施設の3,880施設 (95.8%) から回答を得た。81.7%の施設において、ETRFはコンソールの一部あるいは全台に装着されており、2006年末より3.2%増加した。回答のあった3,880施設には105,516台のベッドサイドコンソールがあり、その59.7%にETRFが装着されており、この比率も昨年より6.3%増加した。

注：エンドトキシン捕捉フィルタ (ETRF) は昨年までエンドトキシンカットフィルタ (ETCF) と称されていたが、2010年改訂予定のISO基準の中で正式にETRFと明記されるため、本邦においてもETRFという名称を正式名称とした。(透析会誌41巻3号参照)