



2) 血液透析濾過調査

(2) 体重あたりの置換液量 (図表29)

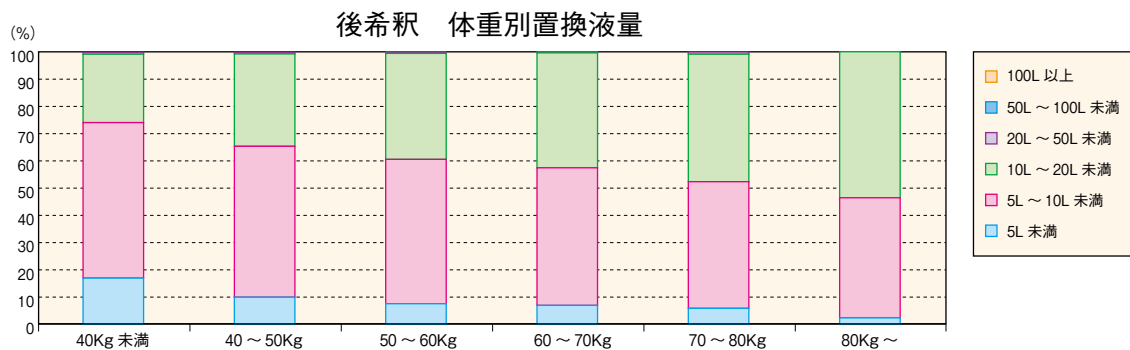

体重	40Kg未満	40~50Kg	50~60Kg	60~70Kg	70~80Kg	80Kg~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5L未満 (%)	93 (17.0)	170 (10.0)	139 (7.6)	78 (7.0)	21 (5.9)	5 (2.4)	506 (8.8)	16	522	50.32	11.39
5L~10L未満 (%)	312 (57.1)	940 (55.4)	976 (53.0)	567 (50.5)	166 (46.5)	93 (44.1)	3,054 (52.9)	72	3,126	53.79	11.99
10L~20L未満 (%)	137 (25.1)	576 (33.9)	715 (38.9)	473 (42.2)	167 (46.8)	113 (53.6)	2,181 (37.8)	22	2,203	56.47	12.87
20L~50L未満 (%)	4 (0.7)	11 (0.6)	10 (0.5)	4 (0.4)	3 (0.8)	0 (0.0)	32 (0.6)	0	32	51.73	11.38
50L~100L未満 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	-	-
100L以上 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	-	-
合計 (%)	546 (100.0)	1,697 (100.0)	1,840 (100.0)	1,122 (100.0)	357 (100.0)	211 (100.0)	5,773 (100.0)	110	5,883	54.49	12.41
記載なし	14	39	42	16	7	5	123	5	128	53.51	12.80
総計	560	1,736	1,882	1,138	364	216	5,896	115	6,011	54.47	12.42
平均	7.76	8.40	8.58	8.84	9.31	9.36	8.57	8.12	8.56		
標準偏差	5.60	8.37	4.06	7.82	5.04	5.08	6.58	6.59	6.58		

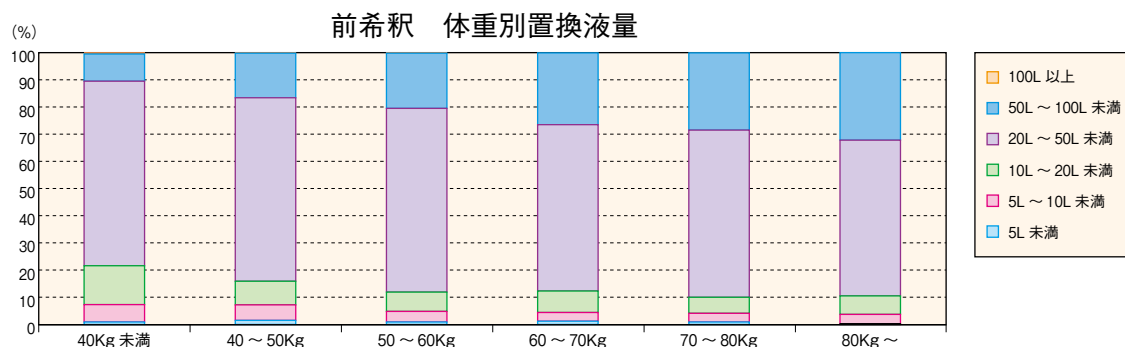

体重	40Kg未満	40~50Kg	50~60Kg	60~70Kg	70~80Kg	80Kg~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5L未満 (%)	7 (0.9)	43 (1.5)	33 (0.9)	29 (1.2)	8 (0.9)	1 (0.2)	121 (1.1)	2	123	54.27	10.62
5L~10L未満 (%)	51 (6.4)	169 (5.7)	146 (3.9)	77 (3.2)	30 (3.2)	18 (3.5)	491 (4.3)	14	505	53.48	12.41
10L~20L未満 (%)	114 (14.3)	258 (8.7)	263 (7.1)	188 (7.9)	55 (5.9)	35 (6.8)	913 (8.1)	7	920	54.07	12.65
20L~50L未満 (%)	542 (67.9)	1,995 (67.5)	2,517 (67.6)	1,460 (61.2)	571 (61.5)	297 (57.3)	7,382 (65.3)	117	7,499	55.70	12.42
50L~100L未満 (%)	80 (10.0)	484 (16.4)	757 (20.3)	630 (26.4)	264 (28.4)	167 (32.2)	2,382 (21.1)	91	2,473	59.56	13.28
100L以上 (%)	4 (0.5)	7 (0.2)	7 (0.2)	1 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	20 (0.2)	1	21	49.48	9.29
合計 (%)	798 (100.0)	2,956 (100.0)	3,723 (100.0)	2,385 (100.0)	929 (100.0)	518 (100.0)	11,309 (100.0)	232	11,541	56.26	12.73
記載なし	9	37	53	31	16	4	150	14	164	56.27	11.90
総計	807	2,993	3,776	2,416	945	522	11,459	246	11,705	56.26	12.72
平均	31.65	35.61	38.02	40.15	41.79	42.27	37.90	45.25	38.04		
標準偏差	16.14	17.75	16.99	19.15	18.34	18.40	17.98	20.93	18.08		

集計対象：血液透析濾過患者

解説

HDF療法の課題に置換液量の標準化の問題があるため、希釈方法の大多数をしめる後希釈と前希釈において、患者の体重区分と置換液量の関連を検討した。後希釈においては40Kg未満から70Kgまでの患者では5~10L置換が最も多く、70Kg以上の患者群においては10~20Lの置換液量が多かった。前希釈においては、どの体重区分においても20~50Lの置換液量がもっとも多かった。後希釈、前希釈とも体重が増加するごとに置換液量が増加する傾向にあったが、置換液量の増加の割合は体重増加の比率より低かった。