



## 4) 血液透析濾過

### (4) HDFの置換液量の推移 (図表27)

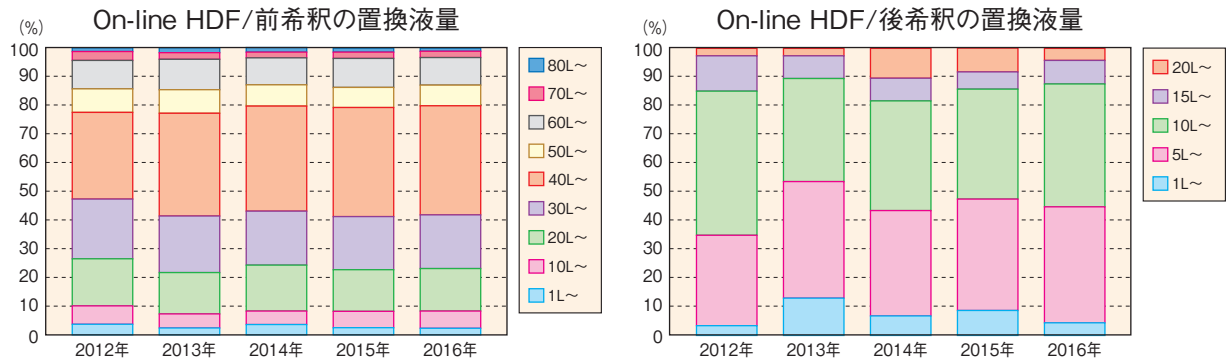

置換液量	1L～	10L～	20L～	30L～	40L～	50L～	60L～	70L～	80L～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2012年 (%)	405 (3.7)	688 (6.3)	1,798 (16.5)	2,261 (20.7)	3,320 (30.4)	898 (8.2)	1,070 (9.8)	343 (3.1)	145 (1.3)	10,928 (100.0)	118	11,046	39.1	16.7
2013年 (%)	452 (2.4)	843 (4.5)	2,678 (14.4)	3,639 (19.6)	6,681 (36.0)	1,541 (8.3)	1,959 (10.6)	436 (2.4)	308 (1.7)	18,537 (100.0)	264	18,801	40.7	15.7
2014年 (%)	1,006 (3.6)	1,310 (4.7)	4,260 (15.3)	5,242 (18.8)	10,344 (37.1)	2,097 (7.5)	2,634 (9.4)	548 (2.0)	443 (1.6)	27,884 (100.0)	899	28,783	39.7	15.9
2015年 (%)	890 (2.5)	1,977 (5.6)	5,092 (14.4)	6,506 (18.4)	13,503 (38.2)	2,473 (7.0)	3,608 (10.2)	785 (2.2)	488 (1.4)	35,322 (100.0)	672	35,994	40.2	15.5
2016年 (%)	1,093 (2.3)	2,839 (6.0)	7,008 (14.8)	8,821 (18.6)	18,082 (38.1)	3,404 (7.2)	4,602 (9.7)	1,033 (2.2)	546 (1.2)	47,428 (100.0)	1,029	48,457	39.9	15.3

置換液量	1L～	5L～	10L～	15L～	20L～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2012年 (%)	29 (3.2)	283 (31.2)	457 (50.4)	113 (12.5)	24 (2.6)	906 (100.0)	36	942	10.6	3.9
2013年 (%)	166 (12.7)	532 (40.8)	467 (35.8)	104 (8.0)	35 (2.7)	1,304 (100.0)	113	1,417	9.2	4.51
2014年 (%)	87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.6	5.0
2015年 (%)	139 (8.7)	618 (38.6)	615 (38.4)	97 (6.1)	131 (8.2)	1,600 (100.0)	17	1,617	10.0	4.8
2016年 (%)	93 (4.2)	887 (40.3)	947 (43.0)	182 (8.3)	92 (4.2)	2,201 (100.0)	26	2,227	10.2	4.0

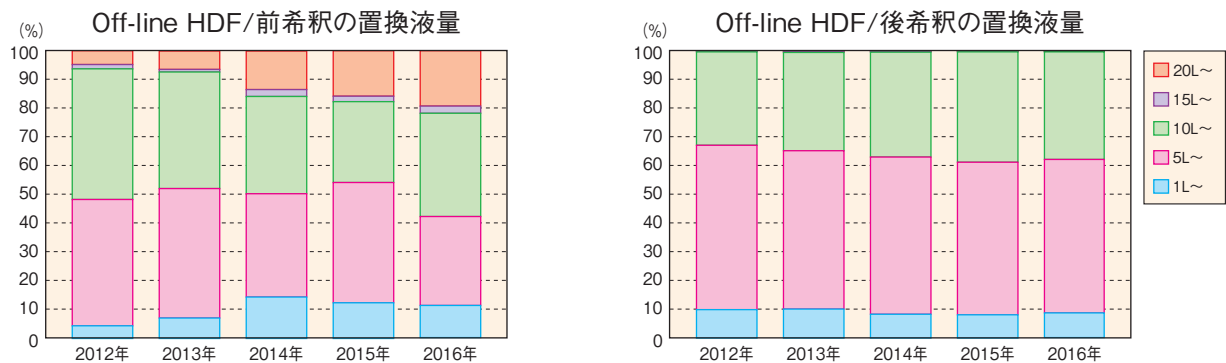

置換液量	1L～	5L～	10L～	15L～	20L～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2012年 (%)	20 (4.4)	198 (43.8)	205 (45.4)	7 (1.5)	22 (4.9)	452 (100.0)	27	479	9.2	3.8
2013年 (%)	39 (7.1)	248 (45.0)	224 (40.7)	5 (0.9)	35 (6.4)	551 (100.0)	20	571	9.4	4.7
2014年 (%)	89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.2	6.6
2015年 (%)	59 (12.8)	188 (40.9)	131 (28.5)	8 (1.7)	74 (16.1)	460 (100.0)	24	484	10.7	7.2
2016年 (%)	53 (11.2)	146 (30.7)	171 (36.0)	12 (2.5)	93 (19.6)	475 (100.0)	26	501	12.0	8.0

置換液量	1L～	5L～	10L～	15L～	20L～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2012年 (%)	471 (9.6)	2,798 (57.1)	1,611 (32.9)	16 (0.3)	5 (0.1)	4,901 (100.0)	69	4,970	7.8	2.3
2013年 (%)	495 (10.0)	2,731 (55.3)	1,683 (34.1)	15 (0.3)	11 (0.2)	4,935 (100.0)	175	5,110	7.8	2.4
2014年 (%)	326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.0	2.3
2015年 (%)	287 (8.1)	1,884 (53.2)	1,363 (38.5)	7 (0.2)	3 (0.1)	3,544 (100.0)	157	3,701	8.1	2.2
2016年 (%)	263 (8.5)	1,676 (53.9)	1,163 (37.4)	7 (0.2)	3 (0.1)	3,112 (100.0)	138	3,250	8.0	2.2

集計対象：血液透析濾過患者（週3回透析）

#### 解説

置換液量はOn-line HDF/前希積が平均39.9Lで最も多く、On-line/後希積は10.2Lであった。Off-line HDFでは、前希積12.0L、後希積8.0Lであった。置換液量の年次推移をみると、On-line HDF/前希積、後希積のいずれにおいても、置換液量やその分布に変化はなかった。一方、Off-line HDF/前希積の置換液量は年々わずかながら増加傾向を示している。Off-line HDF/後希積においては、置換液量はほぼ横ばいで推移している。